



SHIMADZU

LabSolutions

分析报告


<样品信息>

样品名 : DZT-046 2.08MG/ML
样品ID :
数据文件名 : DZT-046 20260304-0.lcd
方法文件名 : 15-40.lcm
批处理文件名 : 20260306-2.lcb
样品瓶号 : 1-11
进样体积 : 10 uL
分析日期 : 2026/03/06 15:43:04
处理日期 : 2026/03/06 16:46:13

样品类型 : 未知
分析者 : System Administrator
处理者 : System Administrator

<色谱图>

mV

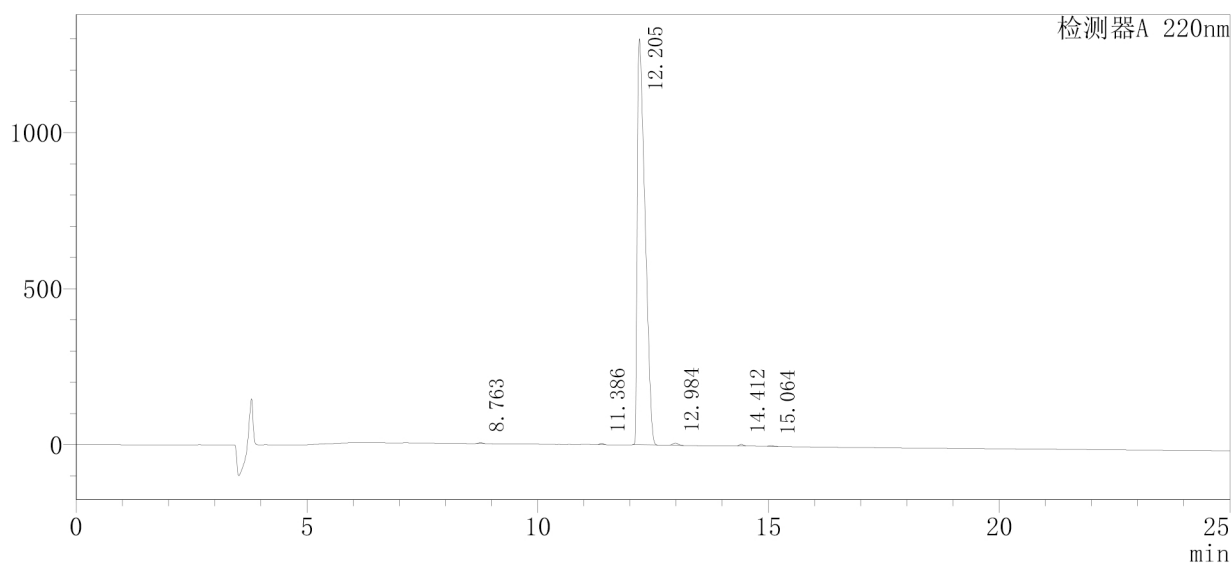

<峰表>

检测器A 220nm

峰号	保留时间	面积	高度	浓度	面积%
1	8.763	15279	2674	0.100	0.100
2	11.386	22611	4355	0.147	0.147
3	12.205	15217300	1300709	99.176	99.176
4	12.984	50240	6618	0.327	0.327
5	14.412	26141	4797	0.170	0.170
6	15.064	12213	1979	0.080	0.080
总计		15343784	1321131		100.000